Implacil DE BORTOLI

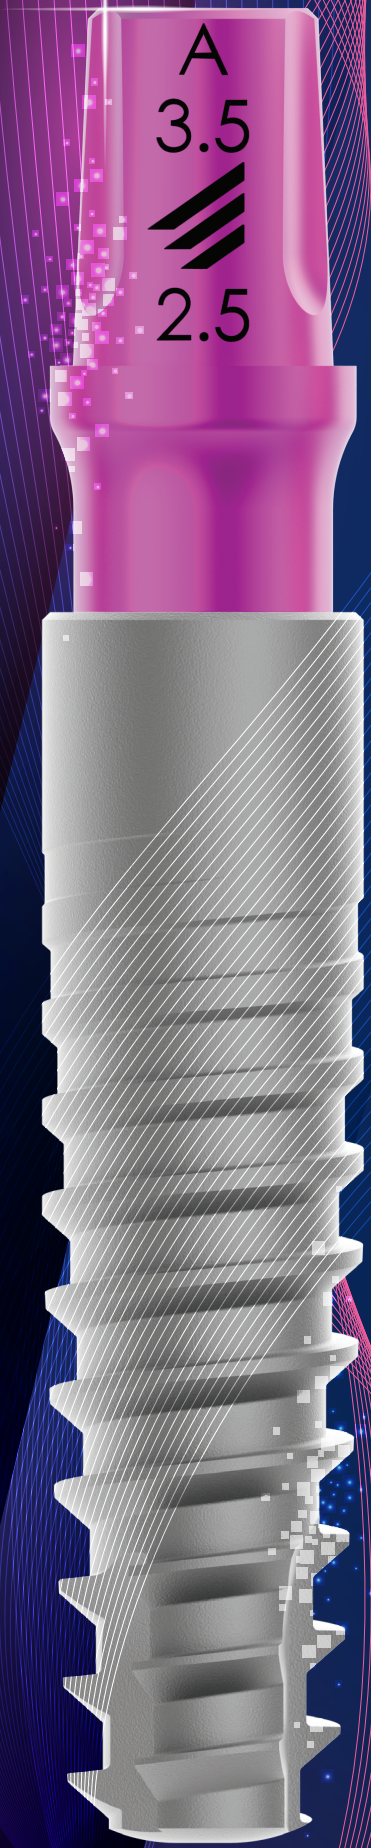

TRANSFORME O LIMITADO EM ILIMITADO!

Stretto

RESULTADO ESTÉTICO INCRÍVEL EM POUCO ESPAÇO

IMPLANTE

STRETTO

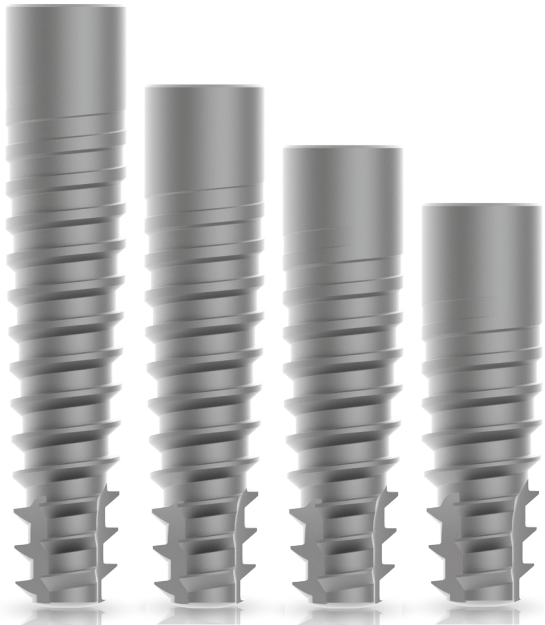

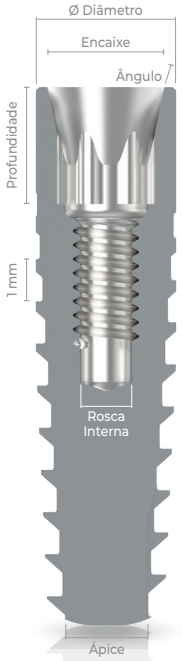

CÓDIGOS

Comprimento	Código
	Ø 3.0 mm
10 mm	34371
11.5 mm	34341
13 mm	34343
15 mm	34345

ESPECIFICAÇÕES

Comprimento	11.5 | 13 | 15 mm
Diâmetro	3.0 mm
Ápice	2.5 mm
Profundidade	2,5 mm
Rosca Interna	1.4 mm
Encaixe	2.5 mm
Ângulo	24°

PILARES DISPONÍVEIS COM ALTURA PROTÉTICA DE 3.5 OU 4.8

SISTEMA CONVENCIONAL DE PRÓTESE (ANALÓGICO) OU SISTEMA DIGITAL (CAD/CAM)

VERSATILIDADE PROTÉTICA: PILAR ANGULADO E HÍBRIDO (PRÓTESE PARAFUSADA E CIMENTADA)

INDICADO PARA CARGA IMEDIATA OU TARDIA

REALMENTE ESTREITO! O DIÂMETRO DO PILAR ACOMPANHA O DIÂMETRO DO IMPLANTE: 3.0MM

ROTAÇÃO DE INSTALAÇÃO: 20 RPM

PODE SER INSTALADO EM QUALQUER DENSIDADE ÓSSEA: OSSO TIPO I II III IV

INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA: APENAS DUAS FRESAS

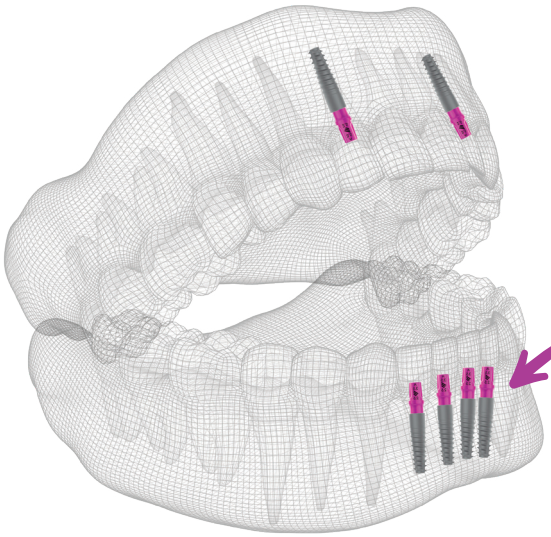

INDICADO PARA ÁREAS COM POUCO ESPAÇO MÉSIO-DISTAL: INCISIVOS INFERIORES E INCISIVOS LATERAIS SUPERIORES

Stretto

Conjunto Stretto – 34595
Estojo Stretto – 34593

Chave Instalação Ø 3.0 CA – 33066

Chave Instalação Ø 3.0 TO – 33063

10.7 cm

Torquímetro 20 a 80 Ncm
24407

Fresa Lança 1.7 mm – 34566

Fresa Escalonada 1.7-2.7 mm – 34564

Macho de Rosca Ø 3.0 mm – 34583

Prolongador de Fresas – 19651

Túnel Check Prótese – 34584

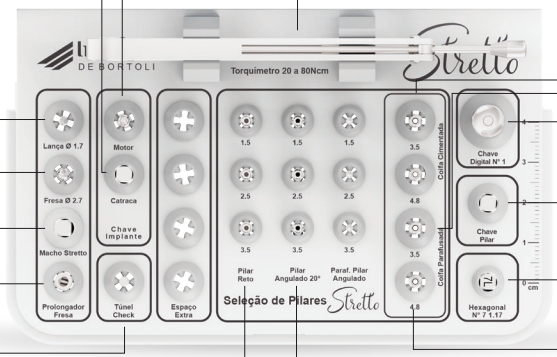

Coifa Cimentada Stretto 3.0x3.5 (Seleção) – 34577

Coifa Cimentada Stretto 3.0x4.8 (Seleção) – 34578

Coifa Parafusada Stretto 3.0x3.5 (Seleção) – 34575

Coifa Parafusada Stretto 3.0x4.8 (Seleção) – 34576

Chave nº 1 Manual Média – 18623

Chave Pilar Stretto 3.0 33626

Chave Hexagonal nº 7 – 1.17 mm Longa – 20619

Parafuso Pilar Angulado 1.5, 2.5 e 3.5

Pilar Stretto 3.0x3.5x1.5 (Seleção) 34572

Pilar Stretto 3.0x3.5x2.5 (Seleção) 34573

Pilar Stretto 3.0x3.5x3.5 (Seleção) 34574

Pilar Angulado Stretto 3.0x3.5x1.5 (Seleção) 34569

Pilar Angulado Stretto 3.0x3.5x2.5 (Seleção) 34570

Pilar Angulado Stretto 3.0x3.5x3.5 (Seleção) 34571

Implante Ø Diâmetro	Tipo ósseo	Fresa lança 1.7 mm 34566	Fresa Escalonada 1.7-2.7 mm 34564	Macho de Rosca Ø 3.0 mm 34583	Chave Instalação Ø 3.0 CA 33066	Chave Instalação Ø 3.0 TO 33063
Ø 3.0	I	▲	▲	●	▲	▲
	II III IV	▲	▲		▲	▲

● Instrumental aplicado conforme diâmetro de implante em situações ósseas corticais de alta densidade.

CA – Contra-ângulo | TO – Torquímetro

PILAR
PROVISÓRIO

Cinta	Diâmetro	Código
1.5 mm	Ø 3.5	34351
2.5 mm	Ø 3.5	34353
3.5 mm	Ø 3.5	34355

Para implantes de 10 mm a 15 mm.

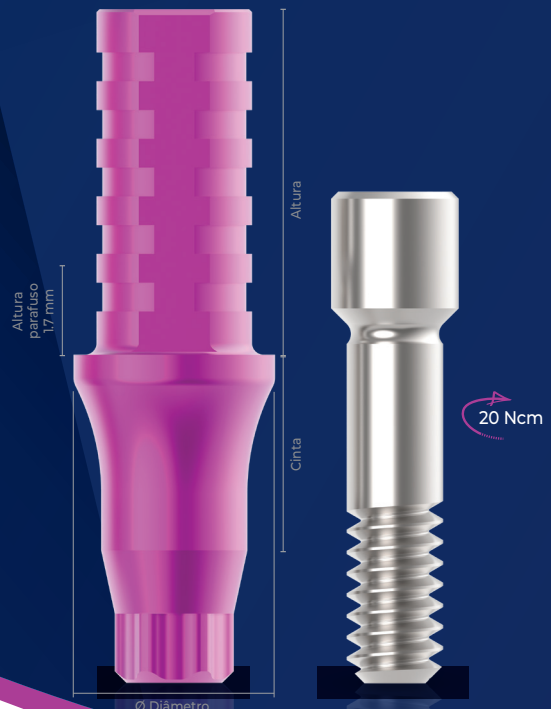

VANTAGENS

- Indicação para casos unitários em incisivos laterais superior e incisivos inferior;
- Pilar indexado;
- Pilar provisório para carga imediata ou tardia;
- Pode ser utilizado na confecção de cicatrizador personalizado com a utilização de resina composta;
- Nas reabilitações através do uso dos pilares Base T, podemos utilizar este pilar para a confecção de provisório parafusado durante o período em que a prótese final estiver sendo confeccionada no CAD/CAM;
- Instalação: Chave Hexagonal nº 7 – 1.17 mm;
- Torque de instalação: 20 Ncm.

SEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO

PROVISÓRIO CLÍNICO

PILAR PROVISÓRIO	ANÁLOGO D/G	CHAVE INSTALAÇÃO
	Análogo Implante Stretto Cód. 33053	Chave Hexagonal nº 7 – 1.17 mm Curta | Cód. 20626 Média | Cód. 18685 Longa | Cód. 20619

PROVISÓRIO LABORATORIAL

TRANSFER CONVENCIONAL	ANÁLOGO D/G	PILAR PROVISÓRIO	CHAVE INSTALAÇÃO
Moldeira Aberta Cód. 34359 Moldeira Fechada Cód. 34361	Análogo Implante Stretto Cód. 33053		Chave Hexagonal nº 7 – 1.17 mm Curta | Cód. 20626 Média | Cód. 18685 Longa | Cód. 20619

CICATRIZADOR
STRETTO

Cinta	Ø 3.0
1.5 mm	33839
2.5 mm	33841
3.5 mm	33055
4.5 mm	33057
5.5 mm	33059

Para implantes de 10 mm a 15 mm.

PILAR
BASE T

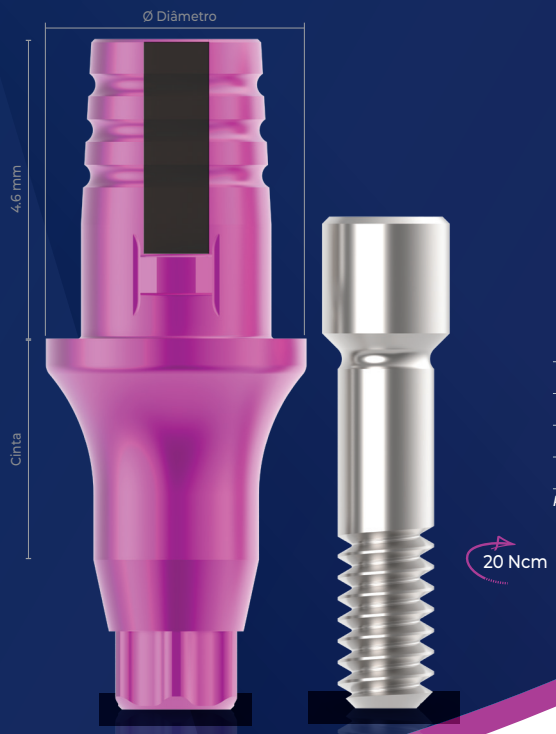

Cinta	Diâmetro	Código
1.5 mm	Ø 3.5	34375
2.5 mm	Ø 3.5	34376
3.5 mm	Ø 3.5	34377

Para implantes de 10 mm a 15 mm.

VANTAGENS

- Indicação para casos unitários em incisivos laterais superior e incisivos inferior;
- Disponível no modelo Base T Small;
- Os pilares Base T são componentes protéticos utilizados para sistemas CAD/CAM;
- Permitem a execução de pilares cerâmicos personalizados para uma ampla gama de soluções individualizadas;
- A linha Base T conta também com o sistema Transfer Digital para implante ou o Transfer Digital Base T para copiar o Base T, que oferece qualidade de superfície superior e uma geometria única para resultados de digitalização de alta precisão;
- Instalação Base T: Chave Hexagonal nº 7 – 1.17 mm;
- Torque de instalação: 20 Ncm;
- Para utilização em Exocad® realize o download no site da Implacil De Bortoli.
- Para utilização em Cerec® seleção do componente no software e seleção do bloco de trabalho, utilize os seguintes codigos 3.5 – Small FX 3.4;

SEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO

ESCANEAMENTO INTRAORAL EXOCAD®

CICATRIZADOR/ PROVISÓRIO	TRANSFER DIGITAL	ANÁLOGO D/G	BASE T	CHAVE INSTALAÇÃO
	Transfer Digital Implante Stretto Cód. 34393	Análogo Implante Stretto Cód. 33053		Chave Hexagonal nº 7 – 1.17 mm Curta | Cód. 20626 Média | Cód. 18685 Longa | Cód. 20619

ESCANEAMENTO INTRAORAL CEREC®

CICATRIZADOR/ PROVISÓRIO	BASE T	SCANCORP	CHAVE INSTALAÇÃO
		Scancorp Ø 3.5 Small Cód. 24803	Chave Hexagonal nº 7 – 1.17 mm Curta | Cód. 20626 Média | Cód. 18685 Longa | Cód. 20619

ESCANEAMENTO LABORATORIAL

CICATRIZADOR/ PROVISÓRIO	TRANSFER CONVENCIONAL	TRANSFER DIGITAL	ANÁLOGO D/G	BASE T	CHAVE INSTALAÇÃO
	Moldeira Aberta Cód. 34359 Moldeira Fechada Cód. 34361	Transfer Digital Implante Stretto Cód. 34393	Análogo Implante Stretto Cód. 33053		Chave Hexagonal nº 7 – 1.17 mm Curta | Cód. 20626 Média | Cód. 18685 Longa | Cód. 20619

PILAR RETO
STRETTO

Diâmetro x Altura		
Cinta	3.0x3.5	3.0x4.8
1.5 mm	34542	33043
2.5 mm	34543	33045
3.5 mm	34544	33047
4.5 mm	34545	33049
5.5 mm	34546	33051

Para implantes de 10 mm a 15 mm.

VANTAGENS

- Indicação para casos unitários em incisivos laterais superior e incisivos inferior;
- Indicado para próteses cimentadas ou parafusadas;
- Diâmetro: 3.0;
- Pilar Reto sólido, corpo único (não possui indexação);
- Reto: cinta de 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 e 5.5 mm;
- Possui análogos, transferentes de moldagem (plástico), coifas de provisório parafusado (titânio) e fundição (plástica) correspondentes ao diâmetro e altura dos pilares;
- Para utilização do Pilar Stretto como elemento parafusado, deverá observar a imagem, e conforme parafuso selecionado deverá acrescentar a altura correspondente ao planejamento; esse aumento é referente a utilização do parafuso para fixação da coroa;
- Para melhor orientação utilize os componentes para seleção, aplique as Coifas de simulação Cimentada ou Parafusada, conforme altura do Pilar aplicado;
- Coifas Plásticas não acompanham parafusos. Opções Hexagonais e Torx vendidas separadamente;
- Coifa Titânio acompanha Parafuso Hexagonal 1.17 mm para Provisório Parafusado ou uso como Tampa de Cicatrização;
- Instalação Pilar: utilizar a Chave Pilar Stretto. Ela poderá ser aplicada em pilares de altura 3.5 ou 4.8;
- Instalação Coifa Parafusada (titânio ou plástica): chave Hexagonal nº 7 – 1.17 mm;
- Torque de instalação Pilar: 20 Ncm;
- Torque de instalação para Coifa quando Prótese Parafusada: 10 Ncm;
- O Pilar conta com toda a linha digital.

Diâmetro	Altura	Chave Instalação	Transfer Analógico	Transfer Digital Exocad®
Ø 3.0 mm	3.5 mm	33626	34349	34563
	4.8 mm		33040	34397

SEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO

PILAR	INSTALAÇÃO	CICATRIZAÇÃO/ PROVISÓRIO	TRANSFER	ANÁLOGO D/G	COIFA (ANALÓGICO)	PARAFUSADA	FINALIZAÇÃO
Reto	Chave Pilar	Coifa Titânio Antirrotacional Parafusada (Provisório/Tampa de Cicatrização)	ANALÓGICO DIGITAL EXOCAD®	Análogo Pilar	Coifa Plástica Antirrotacional Cimentada ou Parafusada (Laboratório Analógico) Cód.	Parafuso Coifa (Parafusada) Parafuso Hexagonal 1.17 mm Parafuso Torx T6 1.4 x 2.7 mm	Elemento Cimentado (**Cimentação**) Elemento **Parafusado** 10 Ncm Chave nº 7 10 Ncm Chave Torx T6

PILAR ANGULADO
STRETTO

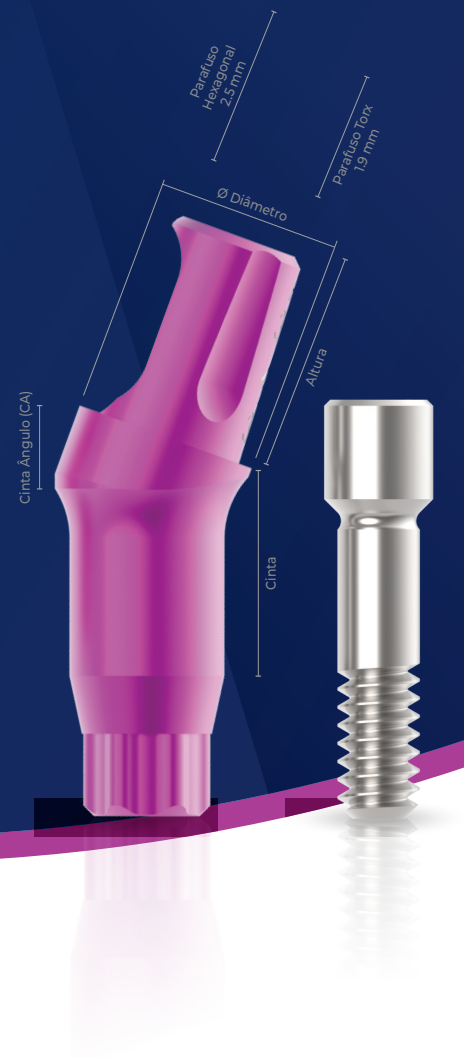

Diâmetro x Altura x Cinta x Cinta Ângulo (CA)			
Cinta	3.0x3.5	3.0x4.8	CA 20°
1.5 mm	33034	34538	2.4 mm
2.5 mm	33036	34539	3.4 mm
3.5 mm	33038	34540	4.3 mm

Para implantes de 10 mm a 15 mm.

Análogo D/G	Coifa Plástica C/P AR	Coifa Titânio P AR	Parafuso Coifa Hexagonal	Parafuso Coifa Torx	Túnel Check Prótese
34565	34347	34535	4763	30131	34584
34357	34348	34536			

Deverá selecionar os componentes conforme a altura do pilar aplicado.

VANTAGENS

- Indicado para casos unitários;
- Indicado para próteses cimentadas ou parafusadas;
- Diâmetro: 3.0;
- Pilar Angulado, em duas peças (pilar indexado);
- Angulado: cinta de 1.5, 2.5 e 3.5 mm;
- Possui análogos, transferentes de moldagem (plástico), coifas de provisório parafusado (titânio) e fundição (plástica) correspondentes ao diâmetro e altura dos pilares;
- Para utilização do Pilar Stretto como elemento parafusado, deverá observar a imagem, e conforme parafuso selecionado deverá acrescentar a altura correspondente ao planejamento; esse aumento é referente a utilização do parafuso para fixação da coroa;
- Para melhor orientação utilize os componentes para seleção, aplique as Coifas de simulação Cimentada ou Parafusada, conforme altura do Pilar aplicado;
- Coifas Plásticas não acompanham parafusos. Opções Hexagonais e Torx vendidas separadamente;
- Coifa Titânio acompanha Parafuso Hexagonal 1.17 mm para Provisório Parafusado ou uso como Tampa de Cicatrização;
- Instalação Pilar: utilizar a Chave Pilar Stretto. Ela poderá ser aplicada em pilares de altura 3.5 ou 4.8;
- Instalação Coifa Parafusada (titânio ou plástica): chave Hexagonal nº 7 – 1.17 mm;
- Torque de instalação Pilar: 20 Ncm;
- Torque de instalação para Coifa quando Prótese Parafusada: 10 Ncm;
- O Pilar conta com toda a linha digital.

SEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO

PILAR	INSTALAÇÃO	CICATRIZAÇÃO/ PROVISÓRIO	TRANSFER	ANÁLOGO D/G	COIFA (ANALÓGICO)	PARAFUSADA	FINALIZAÇÃO
Angulado AR	Chave Hexagonal nº 7 – 1.17 mm Curta | Cód. 20626 Média | Cód. 18685 Longa | Cód. 20619	Coifa Titânio Antirrotacional Parafusada (Provisório/Tampa de Cicatrização)	ANALÓGICO DIGITAL EXOCAD®	Análogo Pilar	Coifa Plástica Antirrotacional Cimentada ou Parafusada (Laboratório Analógico)	Parafuso Coifa (Parafusada) Parafuso Hexagonal 1.17 mm Parafuso Torx T6 1.4 x 2.7 mm	Elemento Cimentado (**Cimentação**) Elemento **Parafusado** Chave nº 7 Chave Torx T6

Revisão: maio de 2024.

Implacil DE BORTOLI